


Ф.И.О. _____

Дата рождения _____



WARANTEC

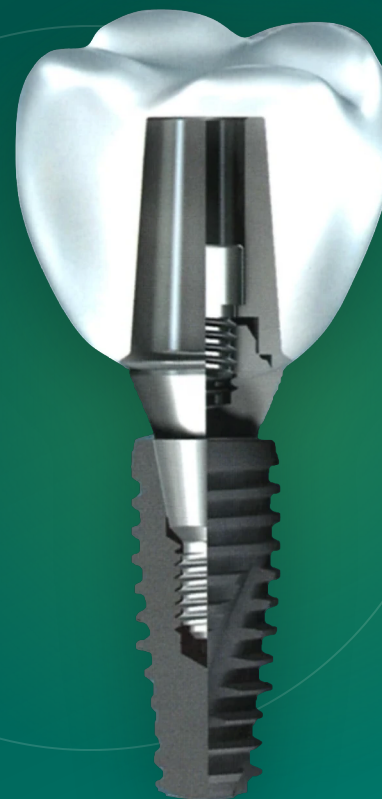

Дизайн системы имплантации IU умело сочетает цилиндрический профиль резьбы и конусное тело импланта

Благодаря тому, что точка максимальной компрессии на 3мм ниже кортикального слоя кости, предотвращается резорбция костной ткани

В то же время квадратная резьба, расположенная в верхней части импланта (кортикальная и субкортикальная область), позволяет достичь отличной первичной стабильности даже в мягкой кости и уменьшить пространственное напряжение в кортикальной кости

паспорт **ИМПЛАНТАТА**

WARANTEC

1 Что необходимо делать после операции:

- **Выполнять холодные компрессы.** Это поможет снизить боль, воспаление и отёк, однако их продолжительность не должна превышать 10 минут.
- **Принимать назначенные лекарства.** Стоматолог может рекомендовать медикаменты для облегчения состояния и профилактики осложнений — средства назначают строго по показаниям и подбирают индивидуально. Стоматолог может назначить медикаменты нескольких фармакологических групп: антибактериальные, противовоспалительные, обезболивающие, местные антисептические, антигистаминные, глюкокортикостероиды и т. д. Продолжительность курса их приема определяется лечащим врачом.

2 Что нельзя делать в первые дни после установки имплантата:

- Первые 3-5 дней воздержитесь от кофе, крепкого чая, пива, вина, шампанского и других подобных напитков. Они повышают давление и могут вызвать кровотечение в области импланта.
- На 3-4 дня полностью исключите любые физические нагрузки. Подъем тяжестей, усиленные нагрузки, контактные тренировки — все это способствует автоматическому сжатию зубов и давлению, которое может спровоцировать усиление боли, открытие кровотечения и расхождение швов.
- Не планируйте авиаперелеты на 10-14 дней (если операция проводилась с наращиванием кости — откажитесь на месяц). При взлетах и посадках самолетов артериальное давление изменяется, что может повлечь усиление отека и кровотечение в области имплантата.
- В течение нескольких недель после имплантации зубов желательно избегать интенсивного жевания оперированной стороной челюсти.
- В первый месяц после операции избегайте перегрева/переохлаждения тела — сауны, бани, плавание в бассейне, реке, озере, море.



WARANTEC


• Дата установки имплантата

--	--	--	--	--	--	--

• Дата фиксации финальной конструкции

--	--	--	--	--	--	--

для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

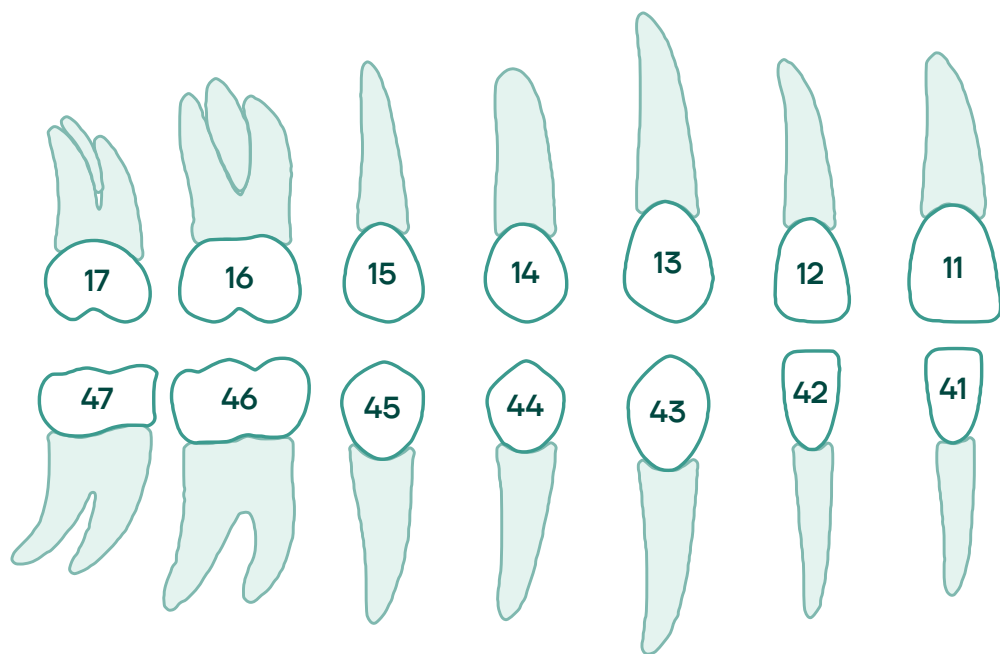

для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

• Дата установки имплантата

--	--	--	--	--	--	--

• Дата фиксации финальной конструкции

--	--	--	--	--	--	--


• Дата установки имплантата

--	--	--	--	--	--	--

• Дата фиксации финальной конструкции

--	--	--	--	--	--	--

для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

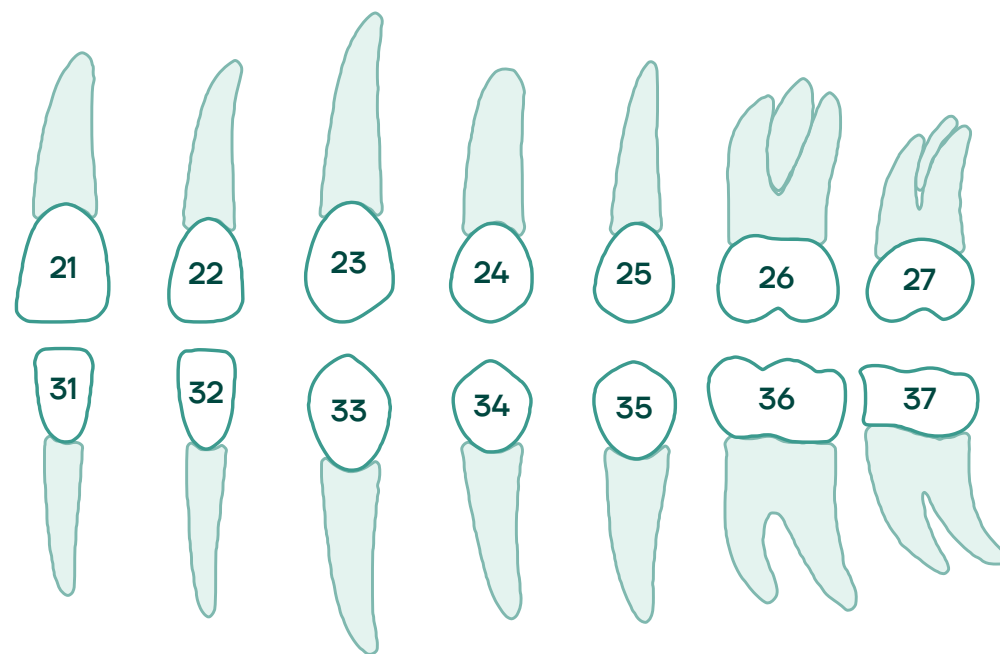

для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек	для наклеек
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

• Дата установки имплантата

--	--	--	--	--	--	--

• Дата фиксации финальной конструкции

--	--	--	--	--	--	--